

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.413411.042 РЭ

Лист
77

- 1 – баллон с ГСО-ПГС;
 2 – вентиль точной регулировки;
 3 – индикатор расхода;
 4 – газоанализатор АНКАТ-310.
 Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4x1,5.

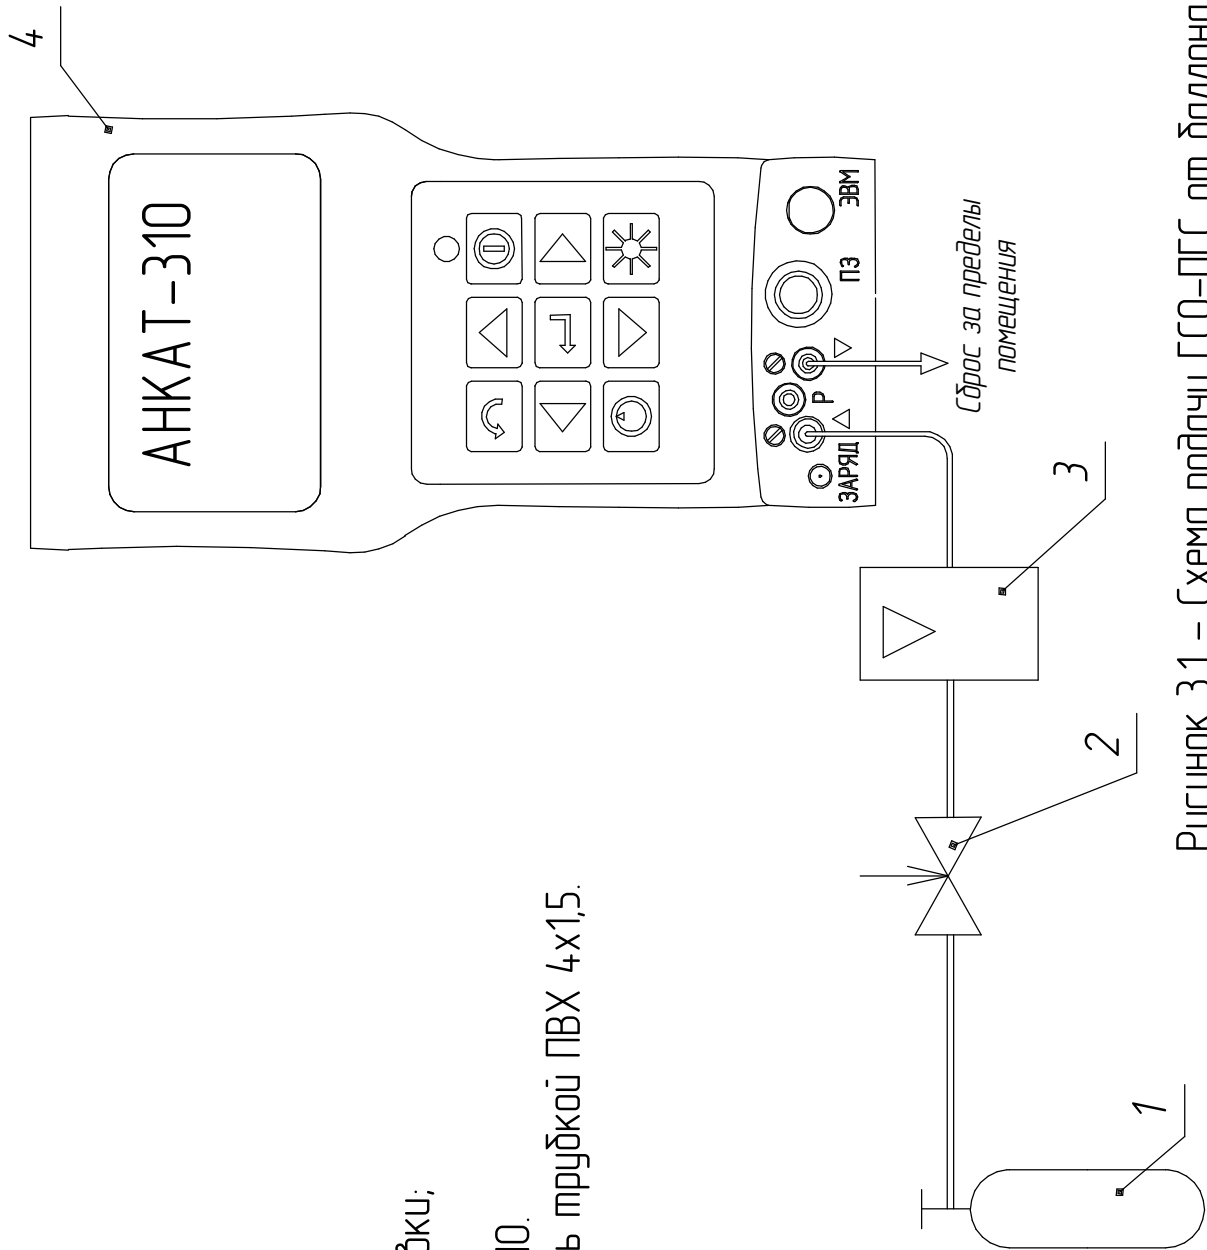


Рисунок 3.1 – Схема подачи ГСО-ПГС от баллона